


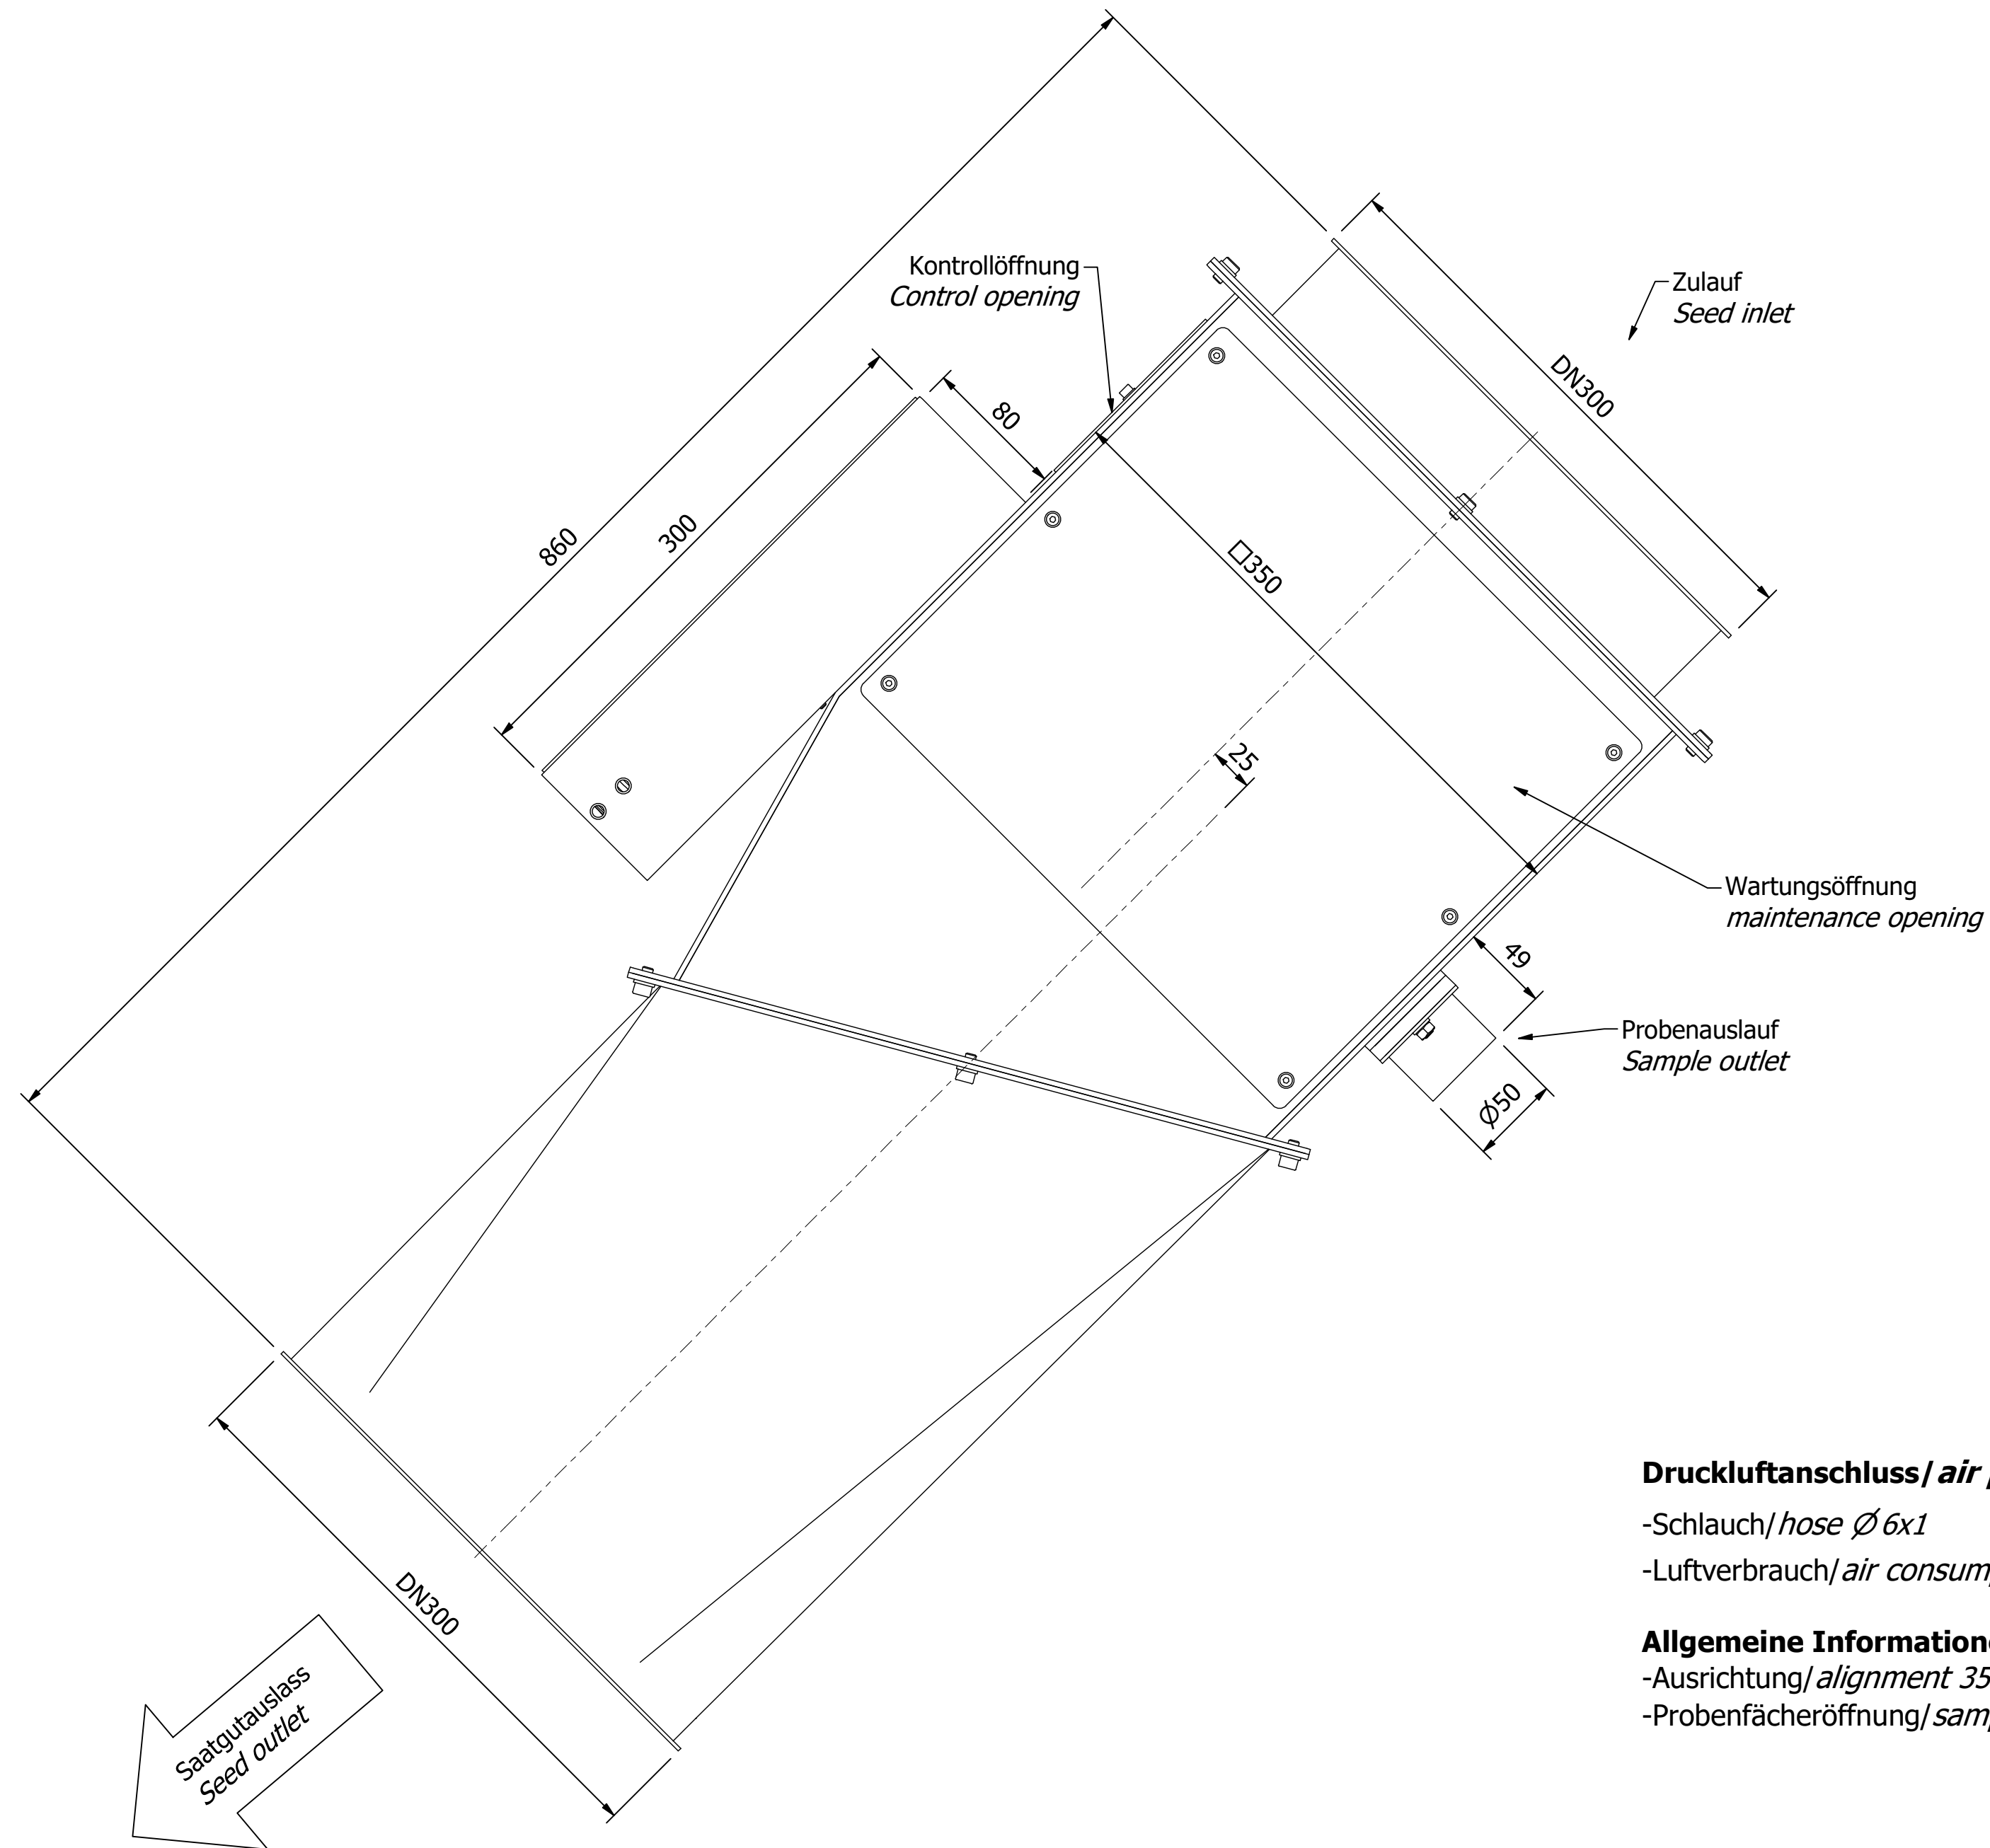

Druckluftanschluss / air pressure connection

- Schlauch / hose $\varnothing 6 \times 1$
- Luftverbrauch / air consumption $\sim 150 \text{ L/h}$ 5-6 bar

Allgemeine Informationen / general information

- Ausrichtung / alignment 35° - 45°
- Probenfächeröffnung / sample fan opening $200 \times 17 \text{ mm}$

Maßblatt / dimension sheet

Probennehmer
sampler



Konstrukteur: Daniel Drews	Projektnummer:	
Datum: 07.02.2024	Maßstab: 1 : 2	
Type: 07-300	1 / 1	